OTICON | **Real**

Технические характеристики

miniBTE R

85

		Real 1	Real 2	Real 3
Разборчивость речи	MoreSound Intelligence™ 2.0	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3
	- Настройка окружения	5 вариантов	5 вариантов	3 варианта
	- Виртуальная ушная раковина	3 настройки	1 настройка	1 настройка
	- Пространственный уравнитель	100%	60%	60%
	- Нейронное подавление шума, сложная ситуация / простая	10 дБ / 4 дБ	6 дБ / 2 дБ	6 дБ / 0 дБ
	- Улучшение звука	3 настройки	2 настройки	1 настройка
	- Wind & Handling Stabilizer	•	•	•
	MoreSound Amplifier™ 2.0	•	•	•
	- SuddenSound Stabilizer	6 настроек	5 настроек	4 настройки
	Подавление обратной связи	MoreSound Optimizer™ и Feedback Shield	MoreSound Optimizer™ и Feedback Shield	MoreSound Optimizer™ и Feedback Shield
	Spatial Sound™	4 полосы	2 полосы	2 полосы
	Усиление тихой речи	•	•	•
	Понижение частоты	Speech Rescue™	Speech Rescue™	Speech Rescue™
Качество звука	Clear Dynamics	•	•	-
	Приоритет «Лучшее ухо»	•	•	-
	Частотный диапазон[1]	10 кГц	8 кГц	8 кГц
	Усиление низких частот (стриминг)	•	•	•
	Каналы обработки	64	48	48
Индивидуализация и оптимизация настройки	Полосы настройки	24	20	18
	Многополосная направленность	•	•	•
	Регулятор привыкания	•	•	•
	Формулы настройки	VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL 5.0	VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL 5.0	VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL 5.0
Возможности подключения	Oticon Companion app	•	•	•
	Связь в режиме «hands-free»[2]	•	•	•
	Прямая потоковая передача[3]	•	•	•
	ConnectClip	•	•	•
	EduMic	•	•	•
	Пульт управления 3.0	•	•	•
	ТВ-адаптер 3.0	•	•	•
	Телефонный адаптер 2.0	•	•	•
	Tinnitus SoundSupport™	•	•	•
	Поддержка CROS/BiCROS	•	•	•

1) Диапазон, доступный для регулировки усиления во время настройки
2) Связь в режиме «hands-free» совместима с моделями iPhone 11 или новее, работающих на iOS 15.2 или новее, и планшетами iPad на iPadOS 15.2 или новее.
3) С iPhone, iPad, iPod touch и отдельными устройствами Android с протоколом для потоковой передачи звука для слуховых аппаратов (ASHA)

Условия работы и зарядки
Температура: от +5 °C до +40 °C (от 41 °F до 104 °F)
Относительная влажность: от 5 до 93 %, без конденсации
Атмосферное давление: от 700 гПа до 1060 гПа

Условия хранения и транспортировки
Температура и влажность не должны превышать следующие пределы в длительный период во время транспортировки и хранения.

Транспортировка
Температура: от -20 °C до +60 °C (от -4 °F до 140 °F)
Относительная влажность: от 5 до 93 %, без конденсации
Атмосферное давление: от 700 гПа до 1060 гПа

Хранение
Температура: от -20 °C до +30 °C (от -4 °F до 86 °F)
Относительная влажность: от 5 до 93 %, без конденсации

Apple, логотип Apple, iPhone, iPad и iPod touch являются торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированной в США и прочих странах.

Oticon Real™ miniBTE R — это небольшой аппарат, который подходит для большинства форм ушей. Устройство оснащено перезаряжаемой литий-ионной батарейкой. Аппарат имеет встроенную телекатушку и одну кнопку-переключатель. Слуховой аппарат использует технологию Bluetooth® Low Energy, совместим с устройствами iPhone («Made for iPhone») и поддерживает связь в режиме «hands-free» и прямую потоковую передачу с iPhone, iPad, iPod touch и отдельными устройствами Android™.

MoreSound Intelligence™ создает более точное и естественное представление отдельных звуков с более ясными и четкими контрастами, обеспечивая доступ ко всем жизненно важным звукам.

Oticon Real построен на платформе Polaris R™, в которой используются более быстрые детекторы для реализации новых инноваций, используемых для оптимизации слышимости звуков окружающей среды в звуковой сцене.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается вносить модификации в данное оборудование.

МЕДАУДИО слуховые аппараты

TwinLink NFMI + 2,4 GHz | Made for iPhone | iPad | iPod | Works with android | IP68

Информацию о совместимости можно получить перейдя по ссылке www.oticon.global/compatibility

oticon life-changing technology

Oticon Real 1

miniBTE R 85



85

Крючок

Corda minifit

Техническая информация
Всенаправленный режим используется, если не указано иное.

		Имитатор уха Измерения проведены в соответствии со стандартами: IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV и IEC 60318-4:2010	Камера связи 2CC Измерения проведены в соответствии со стандартами: ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 и IEC 60318-5:2006
		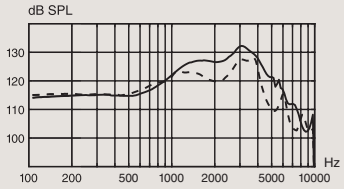	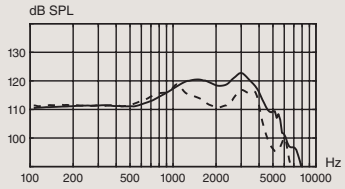
		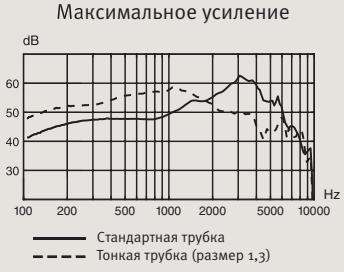	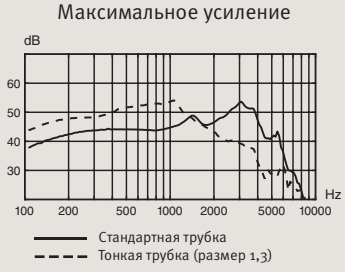
		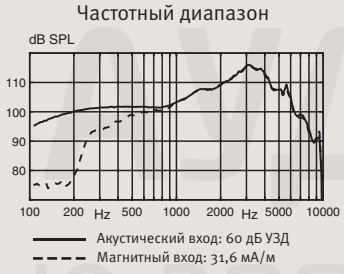	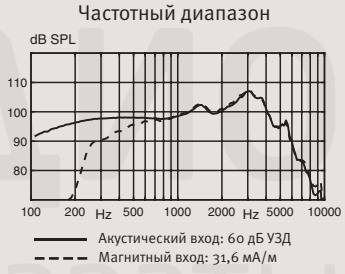
ВУЗД90	Пик (дБ УЗД)	132 (128[1])	123 (119[1])
	1600 Гц (дБ УЗД)	127 (122[1])	120 (114[1])
	HFA-OSPL90 (дБ УЗД)	126 (122[1])	119 (115[1])
Максимальное усиление[2]	Пик (дБ)	63 (59[1])	54 (54[1])
	1600 Гц (дБ)	54 (55[1])	47 (46[1])
	HFA-FOG (дБ)	54 (54[1])	47 (47[1])
Референтное тестовое усиление (дБ)		47	41
Частотный диапазон (Гц)		100-9500	100-7300
Выход телекатушки	Поле 1 мА/м (1600 Гц) (дБ УЗД)	85	
	Поле 10 мА/м (1600 Гц) (дБ УЗД)	105	
	HFA-SPLITS L/R (дБ УЗД)		99/99
Общее гармоническое искажение	500 Гц (%)	<4	<4
	800 Гц (%)	<4	<3
	1600 Гц (%)	<2	<2
Эквивалентный уровень входного шума	Все (дБ УЗД)	19	17
	Направл. (дБ УЗД)	30	31
Аккумулятор		Литий-ионный	Литий-ионный
Ожидаемое время работы, в часах[3]		24	

МЕДАУДИО
слуховые аппараты

1) Для аппаратов с Corda miniFit Power
2) Измерения выполнены с помощью регулятора усиления слуховых аппаратов, установленных в рабочее положение минус 20 дБ, и УЗД на входе 70 дБ. Это необходимо для получения отклика усиления, равного отклику полного усиления, например, IEC 60118-0:1983+A1:1994, но без влияния обратной связи.
3) Ожидаемое время работы перезаряжаемой батарейки зависит от использования аппарата, активных функций, характера снижения слуха, звуковой среды, возраста батарейки и использования беспроводных принадлежностей

Oticon Real 2 & 3

miniBTE R 85



85

Крючок

Corda minifit

Техническая информация
Всенаправленный режим используется, если не указано иное.

		Имитатор уха Измерения проведены в соответствии со стандартами: IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV и IEC 60318-4:2010	Камера связи 2CC Измерения проведены в соответствии со стандартами: ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 и IEC 60318-5:2006
		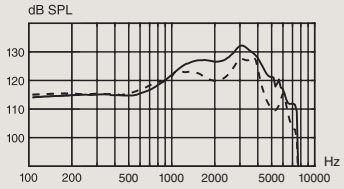	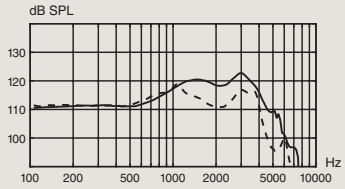
		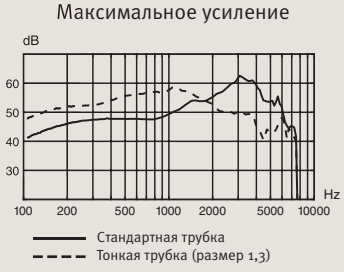	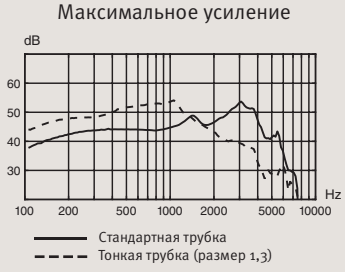
		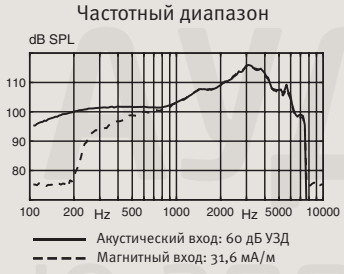	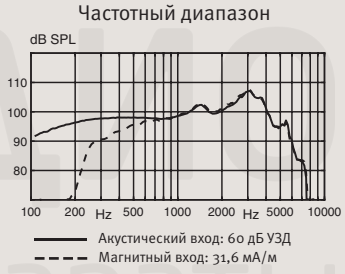
ВУЗД90	Пик (дБ УЗД)	132 (128[1])	123 (119[1])
	1600 Гц (дБ УЗД)	127 (122[1])	120 (114[1])
	HFA-OSPL90 (дБ УЗД)	126 (122[1])	119 (115[1])
Максимальное усиление[2]	Пик (дБ)	63 (59[1])	54 (54[1])
	1600 Гц (дБ)	54 (55[1])	47 (46[1])
	HFA-FOG (дБ)	54 (54[1])	47 (43[1])
Референтное тестовое усиление (дБ)		47	41
Частотный диапазон (Гц)		100-7500	100-7300
Выход телекатушки	Поле 1 мА/м (1600 Гц) (дБ УЗД)	85	
	Поле 10 мА/м (1600 Гц) (дБ УЗД)	105	
	HFA-SPLITS L/R (дБ УЗД)		99/99
Общее гармоническое искажение	500 Гц (%)	<4	<4
	800 Гц (%)	<4	<3
	1600 Гц (%)	<2	<2
Эквивалентный уровень входного шума	Все (дБ УЗД)	19	17
	Направл. (дБ УЗД)	30	32
Аккумулятор		Литий-ионный	Литий-ионный
Ожидаемое время работы, в часах[3]		24	

МЕДАУДИО
слуховые аппараты

1) Для аппаратов с Corda miniFit Power
2) Измерения выполнены с помощью регулятора усиления слуховых аппаратов, установленных в рабочее положение минус 20 дБ, и УЗД на входе 70 дБ. Это необходимо для получения отклика усиления, равного отклику полного усиления, например, IEC 60118-0:1983+A1:1994, но без влияния обратной связи.
3) Ожидаемое время работы перезаряжаемой батарейки зависит от использования аппарата, активных функций, характера снижения слуха, звуковой среды, возраста батарейки и использования беспроводных принадлежностей

Головной офис
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Дания

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark

262582RU / 2022.10.20 / V1

МЕДАУДИО
слуховые аппараты

www.oticon.global

Oticon is part of the Demant Group.

oticon
life-changing **technology**